


正誤表

2008年4月28日現在

弊社書籍 阿部雅子著『構音障害の臨床 -基礎知識と実践マニュアル』2003年7月20日 第1版 第1刷 から第5刷 発行(奥付をご参照ください)の内容に一部誤りがございました。以下の通り訂正し、お詫び申し上げます。

9頁 図1『声門破裂音と正常音の喉頭のX線映画による観察』を次の図に差し替え。

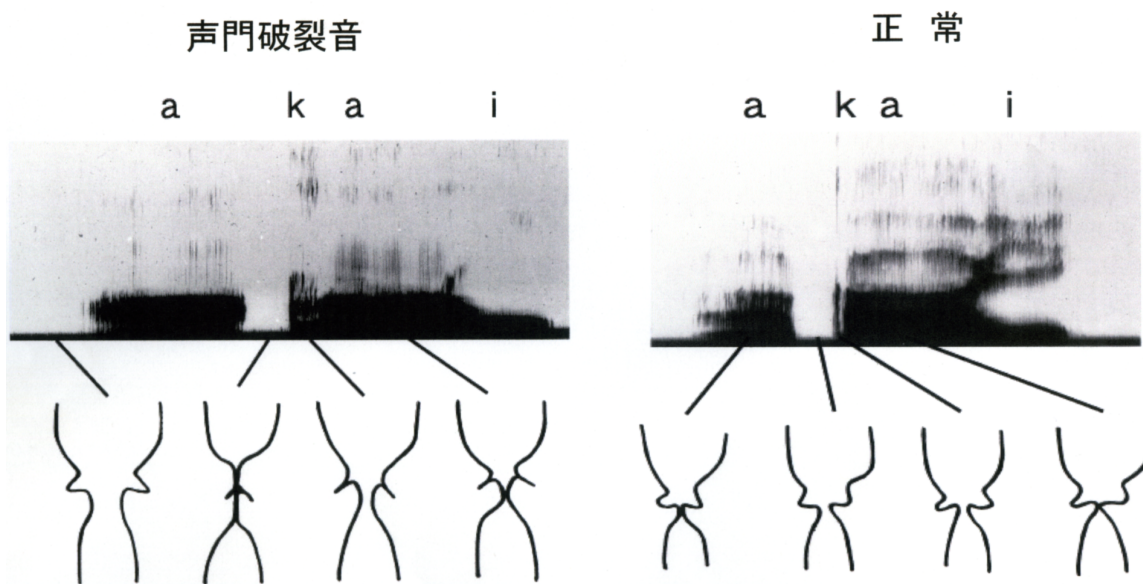

金原出版株式会社